


使用方法



センサーから30~50cm離れ
1秒立ち止まってください

37.5℃以上を検知した場合

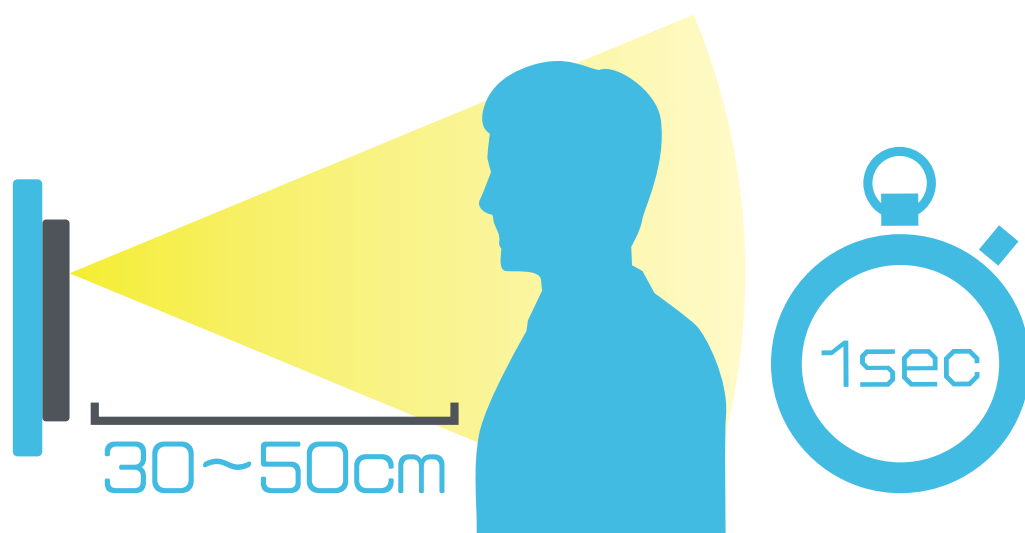

本体中央部が赤く点灯し、
ピッピッとアラーム音が鳴ります



改めて体温計で体温を測定してください

サーモゲート
THERMOGATE

零 ZERO



健康経営企業
HEALTH MANAGEMENT COMPANY